

Sistema di monitoraggio continuo del glucosio

Guida all'avvio dell'APP CGM

Panoramica del sistema i3 CGM


Per le istruzioni e le informazioni complete sul sistema, consultare la Guida dell'utente.

La Guida dell'utente viene fornita in formato elettronico. È possibile visitare il sito web iCan-cgm.com per scaricare un PDF.

Se si necessita di una copia cartacea della Guida dell'utente, contattare il rivenditore o inviare la richiesta all'indirizzo e-mail: support@icancgm.com. Verrà fornita gratuitamente entro sette giorni.

Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail a support@icancgm.com

Tutte le immagini sono a scopo illustrativo. Il prodotto potrebbe avere un aspetto diverso.

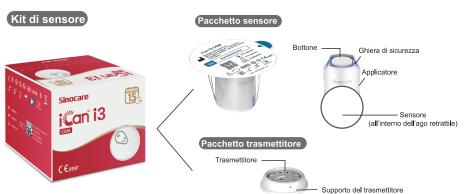



1 Iniziare

Fase 1: Installare l'App iCan CGM

Scaricare l'APP iCan CGM dall'App Store o da Google Play





Fase 2: Accedere al proprio account iCan CGM

a. Effettuare il login se si è già in possesso di un account.
b. Toccare "Registrazione" in basso se si è nuovi utenti.
L'applicazione ti guiderà attraverso video e schermate informative. Toccare "Avanti" per procedere finché non si arriva alla pagina Scansione del codice QR. L'app deve rimanere aperta per tutto il tempo.



2 Abbinare con il trasmettitore

Fase 1: Estrarre il pacchetto trasmettitore



À ® 2 C€m

Pacchetto sensore

S II

dei codici SN (numero di serie)

Separare

Pacchetto trasmettitore

Pacchetto trasmettitore

Estrarre il pacchetto trasmettitore dal fondo della scatola del pacchetto sensore. Prima di associare il sensore al trasmettitore, verificare che le prime 8 cifre dei codici SN del pacchetto sensore e del trasmettitore corrispondano.

Fase 2: Controllare la corrispondenza Fase 3: Abbinare con il trasmettitore





- a. Aprire l'applicazione e assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- b. Accedere al proprio account e, utilizzando l'app, scansionare il codice QR sul pacchetto sensore.
- c. L'accoppiamento avviene automaticamente. Non chiudere l'applicazione e restare nel raggio di 6 metri mentre si procede al passaggio successivo. Se il codice SN è stato inserito manualmente, fare clic su "Avanti" per procedere.
- d. Tenere il telefono a portata di mano e preparare l'inserimento nella fase successiva


3 Inserire il sensore

Per sapere come inserire il sensore, seguire la "Guida rapida del sistema di monitoraggio continuo del glucosio" contenuta nella confezione.

4 Inizio monitoraggio

Fase 1: Avviare il sensore CGM

Fase 2: Attendere che il sensore sia attivo Fase 3: Configurazione allarmi



Quando il sensore è stato inserito correttamente, l'app CGM chiederà di avviare il sensore. Toccare "Avvia" per il passaggio successivo.



Toccare "Avvio" per avviare la fase di attivazione del sensore di 2 ore. Non ci saranno letture del glucosio o avvisi fino al termine della fase di attivazione. Mantenere l'App aperta e il dispositivo smart entro 20 piedi dal trasmettitore durante la fase di attivazione del sensore.

Attenzione: L'utente riceverà sempre un avviso urgente di glucosio basso per impostazione predefinita quando il valore del glucosio del sensore è pari o inferiore a 55 mg/dL. Per informazioni dettagliate sugli avvisi di glucosio e sull'impostazione del sistema, consultare la sezione "Informazioni importanti sulla sicurezza" nelle Istruzioni per l'uso.

Fase 4: Controllare il livello di glucosio



Freccia dell'andamento del glucosio

Direzione in cui il glucosio sta andando

Freccia	Cosa indica	Freccia	Cosa indica
^	II glucosio aumenta rapidamente	7	Glucose falling slowly
1	II glucosio aumenta a velocità moderata	V	Glucose falling quickly
7	II glucosio aumenta lentamente	*	Glucose falling rapidly
\rightarrow	Glucosio stabile		

Grafico del glucosio

Grafico dei valori di glucosio attuali e archiviati



5 Fine monitoraggio

Fase 1: Confermare il completamento della sessione corrente

Al termine della sessione di monitoraggio di 15 giorni, l'App chiederà di sostituire il sensore con uno nuovo o di rivedere il Rapporto cronologico.



Fase 2: Rimuovere il sensore


a. Tirare verso l'alto il bordo dell'adesivo.b. Staccare lentamente l'adesivo dalla pelle con un unico movimento.



Fase 3: Smaltimento

Non toccare il sensore, inoltre il sensore non può essere riutilizzato dopo la rimozione. Smaltire il sensore usato secondo le norme locali.





EC REP OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium

UK REP SUNGO Certification Company Limited 3rd floor, 70 Gracechurch Street, London. EC3V 0HR ukrp@sungodlobal.com

UK REP

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. Korytná 47, 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika

Email: info@quickseal.eu
Tel.: +420 273 167 580 www.quickseal.eu

C€₀₁₉₇